

# 食物アレルギー検出キット アレルギーアイ®

イムノクロマト シングルステップ®

Allergeneye® Immunochromato SingleStep®

## 卵 (オボアルブミン) 【未加熱】

### 取扱説明書

本キットは、卵白に最も多く含まれるタンパク質であるオボアルブミンに対するモノクローナル抗体を用いた金コロイド免疫クロマト法により、食品中に含まれる卵タンパク質を検出する検査キットです。

本キットでは、変性していない卵タンパク質(オボアルブミン)を検出できますが、加熱変性した卵タンパク質は検出できません。加熱製品、あるいは検査対象品の加工工程が不明な場合には、「アレルギーアイ イムノクロマト 卵(オボアルブミン)【加熱】」をご使用ください。

検査にあたっては本説明書をよく読み、操作方法に従い正しく検査してください。

本キットは食品中の特定原材料を検出するための研究用試薬であり、食物アレルギー発症の有無を診断する臨床検査薬などではありません。アレルギー発症には個人差があり、アレルギーの摂取量とアレルギー症状の相関は不明です。

## キットの内容

包装単位:20テスト、5テスト/キット

	名 称	20テスト	5テスト
A	テストストリップ(透明プラ袋個包装、板状乾燥剤入り)	20本	5本
B	検体希釈液(10倍濃縮)	50 mL×2本	25 mL×1本
C	取扱説明書	1枚	1枚


## 目的・性能

食品中に含まれる未加熱卵タンパク質(オボアルブミン)の検出

検査試料中の卵タンパク質を5ng/mL以上(被検食品当りに換算した場合約2ppm以上)の濃度で検出可能

## 原 理

1. 検査試料中に卵タンパク質が含まれる場合、検査試料にテストストリップをつけると、試薬紙中の金コロイド標識抗体-Aと卵タンパク質が複合体を形成します。
2. 複合体はテストストリップ上を移動し、固定化抗体-Bに捕捉され、赤紫色の判定ラインが確認されます。
3. 卵タンパク質が含まれない場合は、複合体が形成されないため、判定ラインは確認されません。

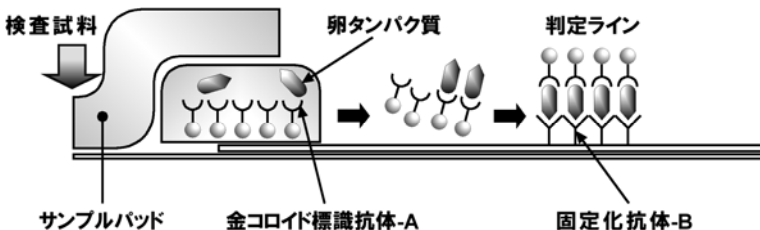

## 操作方法 1:検査試料の調製

### 1. 準備するもの(例)

- ・ メスシリンダー
- ・ ホモジナイザー
- ・ メスピベット
- ・ ポリプロピレン製遠沈管(50mL)
- ・ 蒸留水
- ・ 遠心分離機
- ・ サンプリング用ビニール袋
- ・ 漏斗、ろ紙
- ・ フードプロセッサ―またはミキサー
- ・ タイマー

※実験器具からのコンタミネーションによりアレルゲン混入の判定が困難にならないよう、使用する実験器具は中性洗剤で洗浄後、アルカリ洗剤などで漬け置き(1晩)し、十分に水道水で洗った後、蒸留水ですすいでください。

### 2. 検体希釈液の準備

「B:検体希釈液(10倍濃縮)」を蒸留水で10倍に希釈し**検体希釈液**を調製します。

※例)50mL 調製の場合:「B:検体希釈液(10倍濃縮)」5mLに対して、蒸留水45mLを加えてください。

※泡立ちますので、なるべく泡立たせないように希釈してください。

※「B:検体希釈液(10倍濃縮)」はまれに沈殿を生じることがあります。その場合は、ぬるめのお湯で容器ごと温めて沈殿を完全に溶かしてください。お湯で温めた後は、室温程度に冷やしてから検査に使用してください。

### 3. 検査試料の調製(希釈操作が必要です。)

- (1) 検査サンプルを均一になるようにフードプロセッサ―やミキサーなどで粉碎・混合します。
- (2) 均一にした検査サンプルを50mLの遠沈管に1g量り取り、**検体希釈液**を39mL加え、ホモジナイザーなどでよく攪拌、抽出します(約30秒を3回繰り返す)。  
※酸性およびアルカリ性の食品などは、抽出後のpHが中性付近(pH6.0~8.0)ではなくなることがあります。その場合はpHを確認し、必要に応じて中性付近(pH6.0~8.0)になるように調整します。
- (3) (2)の溶液をろ紙でろ過します。  
※ろ液の回収が困難な場合は、遠心分離(例えば3,000×g、20分間)を行い、上清を分取したのち、ろ紙でろ過してください。  
※遠心分離の際にはサンプルの温度が室温(20℃~25℃)となるようにしてください。
- (4) (3)で得られた**ろ液**を**検体希釈液**で10倍希釈したものを**検査試料**とし、**検査**に使用します。


## 操作方法 2:テストストリップによる検査

テストストリップを冷蔵保存している場合には、袋のまま室温に戻してから使用してください。

- (1) テストストリップを透明ブラ袋から取り出します。

※テストストリップは、使用直前に袋から取り出してください。


※テストストリップは、持ち手部を持ってください。

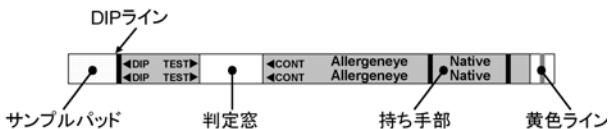

- (2) 検査試料にテストストリップのサンプルパッド部分をDIPラインの位置まで入れ、3秒間つけて取り出します。

※テストストリップをつける際は、DIPラインより深すぎたり浅すぎたりしないように注意してください。

※テストストリップは3秒間つけて取り出し、つけたまま放置しないでください。

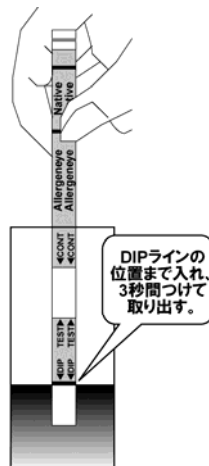

(3) テストストリップの判定窓を上に向けて水平に静置し、**15分後**に、判定を行います。

※テストストリップは、ティッシュペーパーなど吸収性のあるものの上に置かないでください。

※あらかじめ、ラップやアルミホイルなどを広げておき、その上にテストストリップを置くと便利です。

※コンタミネーションによる偽陽性などを防ぐため、ラップやアルミホイルは、使い捨てにしてください。

## 判 定

●陽性:赤紫色の判定ラインとピンク色の確認サインの 2本のラインが確認されます。



検査試料中に 5ng/mL 以上の卵タンパク質が含まれています。被検食品当りに換算した場合約 2ppm 以上に相当します。

※ラインの着色の濃さにかかわらず、赤紫色の判定ラインが確認できた場合は、陽性と判定してください。


●陰性:ピンク色の確認サインのみが発色し、判定ラインは確認されません。



検査試料中には、卵タンパク質(オボアルブミン)が含まれていないか、含まれている場合でも卵タンパク質が検出感度未満であると推測されます。


●再検査:確認サインが発色しません。

確認サインが発色しなかった場合は、正しく検査が行われなかった可能性がありますので、判定を保留し、新しいテストストリップで再度検査を行ってください。



### 判定上の注意

- (1) 加熱変性した卵タンパク質は検出できません。
- (2) 卵以外の特定原材料(牛乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)に対しては、交差反応を示しません。
- (3) 特定原材料のウズラ卵、アヒル卵タンパク質に対しては交差反応を示します。
- (4) 正しい判定結果を得るために、テストストリップを検査試料につけてから **15分後**に判定し、それ以降は判定を行わないでください。検査試料中に検出感度未満の低濃度の卵タンパク質が含まれている場合や非特異的な反応などで、時間が経過すると判定ラインが着色してくる場合があります。
- (5) ラインの全体が着色せず、右図の様の一部のみが着色した場合は、判定を保留し、新しいテストストリップで再度検査を行ってください。
- (6) 粘性の高い食品や着色程度の高い食品では正確に判定できない場合がありますので、適宜希釈して検査を行ってください。



## 使用上または取扱い上の注意

### 1. 一般的な注意

- (1) 本キットは食品中に含まれる未加熱の卵タンパク質(オボアルブミン)を検出するための定性試薬ですので、他の用途には使用しないでください。
- (2) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。(使用期限は外箱及び透明ブラ袋等に表示されています。)
- (3) 本キットは直射日光や熱源を避け、室温で検査してください。
- (4) 廃棄方法は自治体の条例に従ってください。テストストリップ(PETなど)及び乾燥剤(バルブ)は、焼却処分が可能です。

※素材：透明ブラ袋(PE など)、検体希釈液容器(本体 PE、ふた PP)・ラベル(PET)、取扱説明書(紙)

20 テスト：外箱・ラベル・中仕切り(紙)

5 テスト：中箱(紙)・ラベル(PET)、チャック付袋(OP/CP)・ラベル(紙)

### 2. 操作上の注意

- (1) 微量でも手に付いたアレルゲンが混入するおそれがあるため、検査にあたっては、手をきれいに洗ってください。
- (2) テストストリップの入った袋は使用直前に開封してください。また、袋が破損している場合には、誤った結果となるおそれがありますので、そのテストストリップは使用しないでください。
- (3) 検体の吸収が悪くなる場合がありますので、サンプルパッドには手を触れないでください。
- (4) 使用前に判定紙がぬれてしまうと正しく判定できません。その際は、使用を中止し、新しいテストストリップを用いて検査してください。
- (5) サンプル中の卵タンパク質濃度がきわめて高濃度の場合、逆に判定ラインが出なくなる現象(ブローン現象)が起こるため、希釈操作を必ず行ってください。
- (6) テストストリップを検査試料につける際には、DIPラインまで正確に入れ、3秒間つけて取り出してください。

### 3. 危険防止上の注意事項

- (1) 本キットの試薬類は、皮膚や粘膜、衣類等に付けないでください。
- (2) 「B:検体希釈液(10倍濃縮)」には、アジ化ナトリウムが含まれています。廃棄の際には、大量の水と一緒に流してください。
- (3) 誤って試薬が目や口に入った場合には、直ちに水道水で十分に洗い流す等の応急処置を行い医師の手当てを受けてください。

### 4. その他

- (1) 本キットによる判定の結果は、製造記録や他の測定方法なども合わせ総合的に評価してください。
- (2) 本キットの検査結果を使用した結果として発生した損害及び損失については、責任を負いません。

## 貯法・使用期限

1. 貯 法 高温高湿を避けて室温(1~30℃)で保存してください。
2. 使用期限 外箱及び透明ブラ袋等に表示

## 包装単位

20 テスト、5 テスト

発売元／お問い合わせ先：プリマム株式会社 基礎研究所 TEL:029-842-4333 FAX:029-842-5216

nOA105